




## Informe quirurgico

Detalles de pedido

**APROBADO**

**Nombre del paciente:** Cristina Suaza Gregory Ross  
**Referencia de pedido del cliente:** 37049\_20240604\_1213\_57  
**Fecha de creación:** 4/06/2024 3:26:08 p. m.  
**Aprobado por:** Default user (e64fecf5-df70-4a6d-a71c-8649c95a82d2)

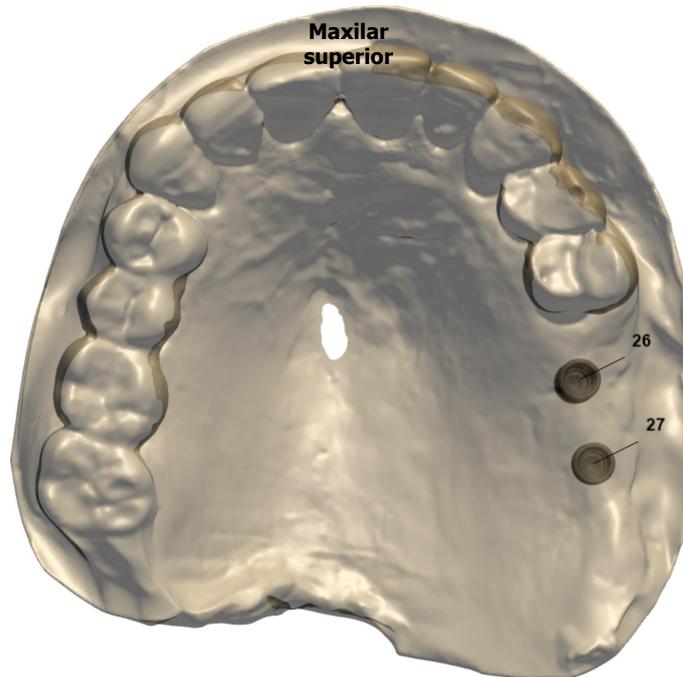





Información de implante	
Posición de implante (FDI)	26
Fabricante	Straumann
Tipo	BLT, Ø 4.1 mm RC, SLActive® 10 mm, Roxolid®, Loxim®
Número de pedido	021.5310
Longitud, mm	10
Diámetro (Ø), mm	4,1
Color	Red

Información de implante	
Posición de implante (FDI)	27
Fabricante	Straumann
Tipo	BLT, Ø 4.1 mm RC, SLActive® 10 mm, Roxolid®, Loxim®
Número de pedido	021.5310
Longitud, mm	10
Diámetro (Ø), mm	4,1
Color	Red

**Limitación de responsabilidad:**

Esta instrucción recoge un documento personalizado que se basa en un plan quirúrgico propuesto por el cirujano antes de la operación. El cirujano, por lo tanto, asume plena responsabilidad por el diseño y la aplicación de la guía quirúrgica, el kit de la cubeta quirúrgica, implantes y casquillos, todos tal y como se especifica en el formulario de pedido recibido por el proveedor. El documento personalizado se considerará como un anexo de todos los demás documentos enviados relacionados con el caso, y no sustituye a ningún otro de esos documentos.




Implante Información		
Posición de implante (FDI)	26	
Fabricante	Straumann	
Tipo	BLT, Ø 4.1 mm RC, SLActive® 10 mm, Roxolid®, Loxim®	
Número de pedido	021.5310	
Longitud, mm	10	
Diámetro (Ø), mm	4,1	
Color	Red <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: red; vertical-align: middle;"></span>	
Zona de seguridad - distancia apical	2,0	
Zona de seguridad - distancia radial	1,5	

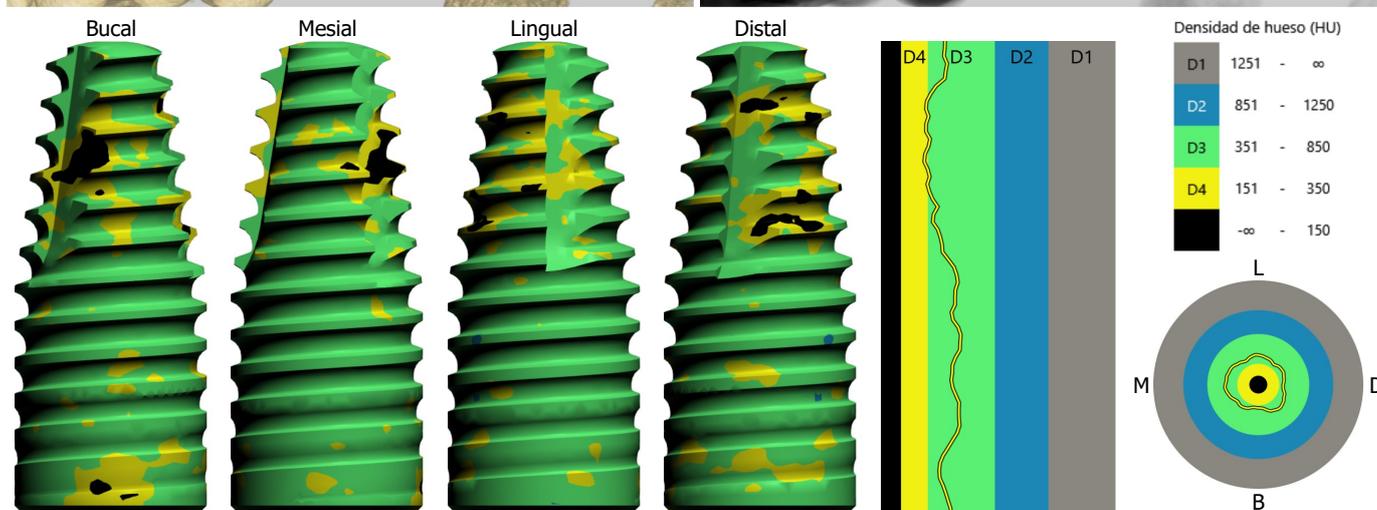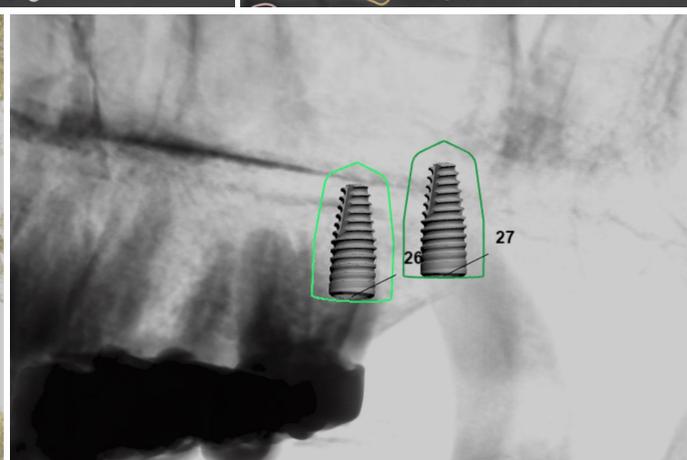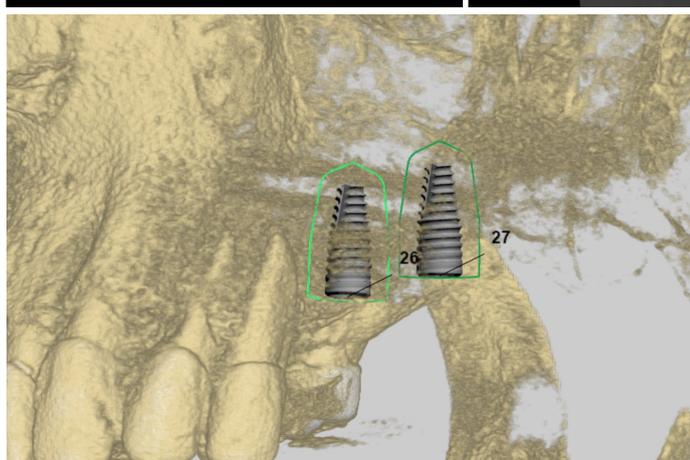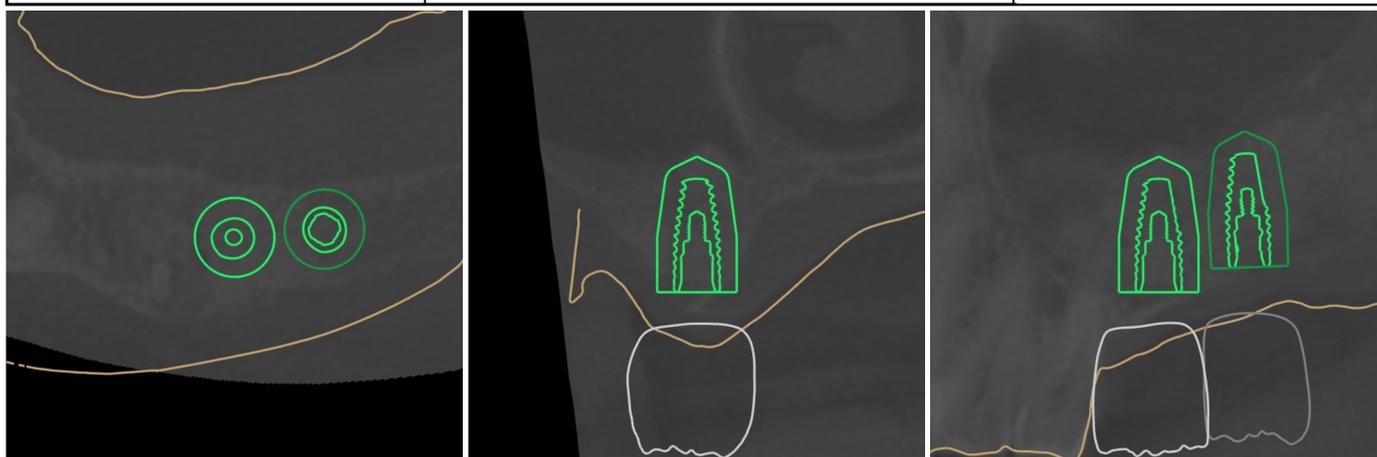

**Limitación de responsabilidad:**

Esta instrucción recoge un documento personalizado que se basa en un plan quirúrgico propuesto por el cirujano antes de la operación. El cirujano, por lo tanto, asume plena responsabilidad por el diseño y la aplicación de la guía quirúrgica, el kit de la cubeta quirúrgica, implantes y casquillos, todos tal y como se especifica en el formulario de pedido recibido por el proveedor. El documento personalizado se considerará como un anexo de todos los demás documentos enviados relacionados con el caso, y no sustituye a ningún otro de esos documentos.

Implante Información		
Posición de implante (FDI)	27	
Fabricante	Straumann	
Tipo	BLT, Ø 4.1 mm RC, SLActive® 10 mm, Roxolid®, Loxim®	
Número de pedido	021.5310	
Longitud, mm	10	
Diámetro (Ø), mm	4,1	
Color	Red 	
Zona de seguridad - distancia apical	2,0	
Zona de seguridad - distancia radial	1,5	

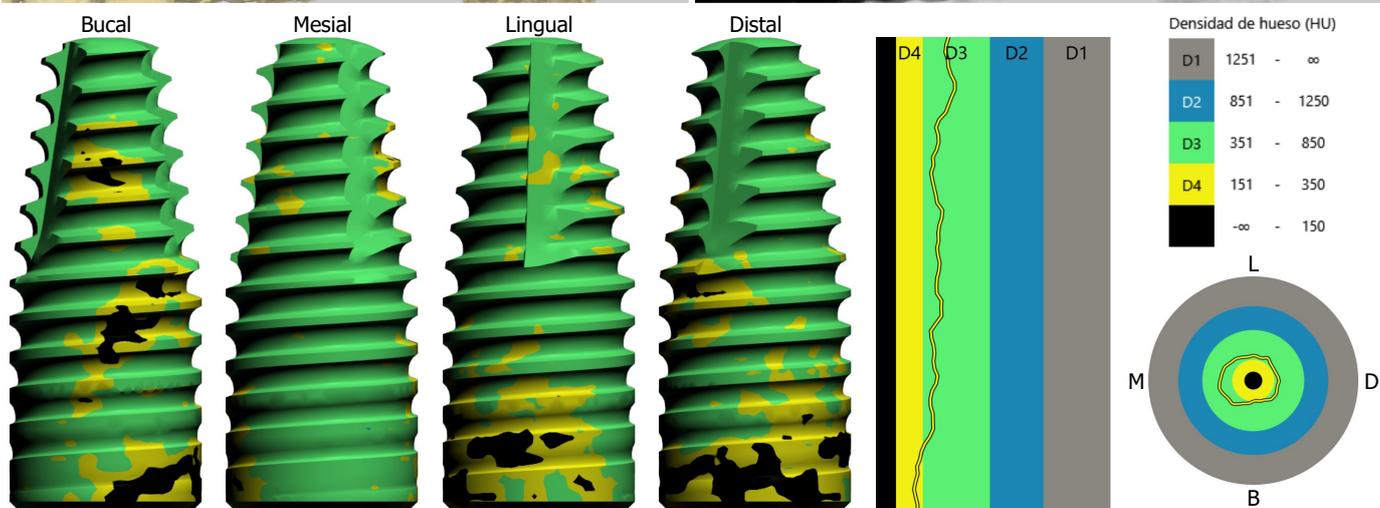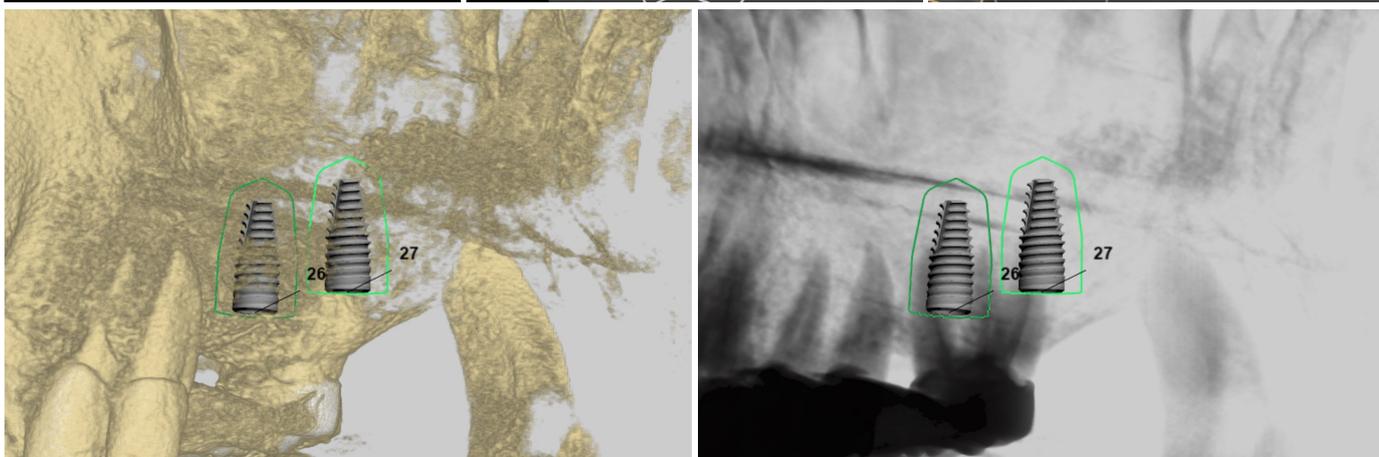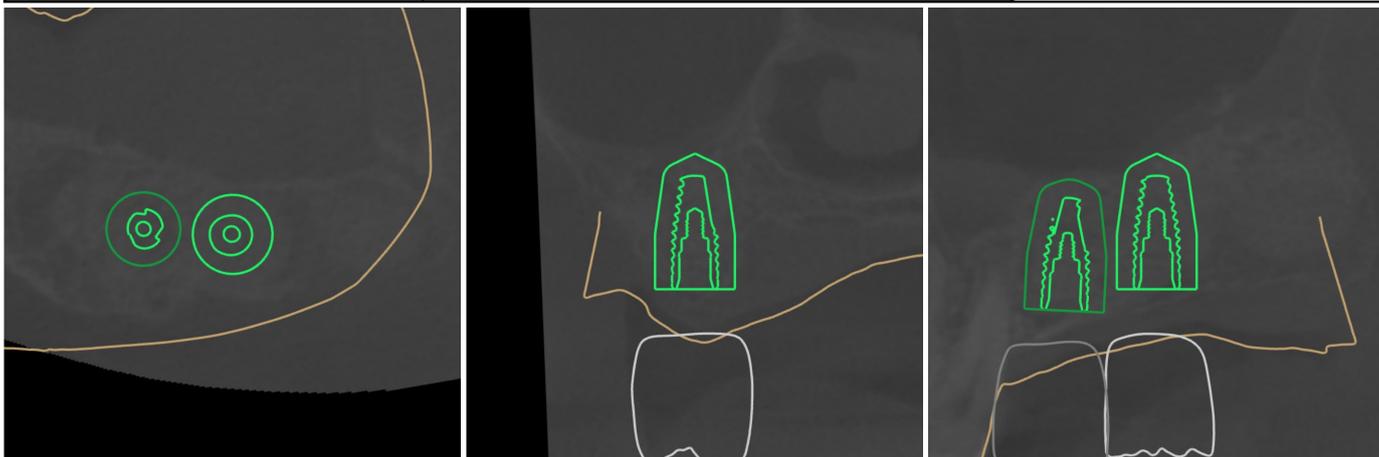

**Limitación de responsabilidad:**

Esta instrucción recoge un documento personalizado que se basa en un plan quirúrgico propuesto por el cirujano antes de la operación. El cirujano, por lo tanto, asume plena responsabilidad por el diseño y la aplicación de la guía quirúrgica, el kit de la cubeta quirúrgica, implantes y casquillos, todos tal y como se especifica en el formulario de pedido recibido por el proveedor. El documento personalizado se considerará como un anexo de todos los demás documentos enviados relacionados con el caso, y no sustituye a ningún otro de esos documentos.